

ProTaper Ultimate™ lahendus

Lahendus, kus on kombineeritud viimase põlvkonna ProTaperi instrumentid, täiustatud desinfitseerimine ja spetsiaalselt loodud obturatsiooni süsteem, millel on laitmatu omavaheline sobivus

Kujundamine

STANDARD

Slider 016.002v



Shaper 020.004v



F1 020.007v



F2 025.008v



F3 030.009v



SUUREMAD JA SIRGEMAD KANALID AINULT

Slider 016.002v



FX 035.012v



FXL 050.010v



Irrigatsioon



SmartLite® Pro EndoActivator®

Varsti tulemas



Irrigatsioonikanüül

Obturatsioon


Pabertihvtid



AH Plus® Bioceramic siiler



Conform Fit® guttaperts tihvtid

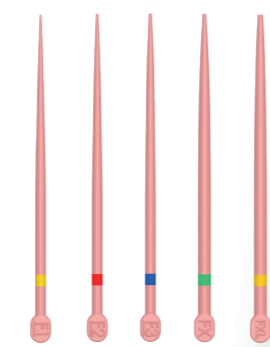

MAILLEFER ProTaper Ultimate™

Tootesortiment

ProTaper Ultimate™ roteeruvad instrumentid

SX	19 mm	B ST PULR 619 OSX	x6
Slider - libetee viil	21 mm	B ST PULR 321 OSL	x3
	25 mm	B ST PULR 325 OSL	x3
	31 mm	B ST PULR 331 OSL	x3
	21 mm	B ST PULR 621 OSL	x6
	25 mm	B ST PULR 625 OSL	x6
	31 mm	B ST PULR 631 OSL	x6
Shaper	21 mm	B ST PULR 321 OSH	x3
	25 mm	B ST PULR 325 OSH	x3
	31 mm	B ST PULR 331 OSH	x3
	21 mm	B ST PULR 621 OSH	x6
	25 mm	B ST PULR 625 OSH	x6
	31 mm	B ST PULR 631 OSH	x6
F1	21 mm	B ST PULR 321 OF1	x3
	25 mm	B ST PULR 325 OF1	x3
	31 mm	B ST PULR 331 OF1	x3
	21 mm	B ST PULR 621 OF1	x6
	25 mm	B ST PULR 625 OF1	x6
	31 mm	B ST PULR 631 OF1	x6
F2	21 mm	B ST PULR 321 OF2	x3
	25 mm	B ST PULR 325 OF2	x3
	31 mm	B ST PULR 331 OF2	x3
	21 mm	B ST PULR 621 OF2	x6
	25 mm	B ST PULR 625 OF2	x6
	31 mm	B ST PULR 631 OF2	x6
F3	21 mm	B ST PULR 321 OF3	x3
	25 mm	B ST PULR 325 OF3	x3
	31 mm	B ST PULR 331 OF3	x3
	21 mm	B ST PULR 621 OF3	x6
	25 mm	B ST PULR 625 OF3	x6
	31 mm	B ST PULR 631 OF3	x6
FX	21 mm	B ST PULR 621 OFX	x6
	25 mm	B ST PULR 625 OFX	x6
	31 mm	B ST PULR 631 OFX	x6
FXL	21 mm	B ST PULR 621 FXL	x6
	25 mm	B ST PULR 625 FXL	x6
	31 mm	B ST PULR 631 FXL	x6
ASSORTII PAKID			
Slider, Shaper, F1, F2, F3	21 mm	B ST PULR 521 SQE	x5
	25 mm	B ST PULR 525 SQE	x5
	31 mm	B ST PULR 531 SQE	x5

ProTaper Ultimate™ käsiinstrumendid

SX	19 mm	B ST PULH 619 OSX	x6
Slider - libetee viil	21 mm	B ST PULH 621 OSL	x6
	25 mm	B ST PULH 625 OSL	x6
	31 mm	B ST PULH 631 OSL	x6
Shaper	21 mm	B ST PULH 621 OSH	x6
	25 mm	B ST PULH 625 OSH	x6
	31 mm	B ST PULH 631 OSH	x6
F1	21 mm	B ST PULH 621 OF1	x6
	25 mm	B ST PULH 625 OF1	x6
	31 mm	B ST PULH 631 OF1	x6
F2	21 mm	B ST PULH 621 OF2	x6
	25 mm	B ST PULH 625 OF2	x6
	31 mm	B ST PULH 631 OF2	x6
F3	21 mm	B ST PULH 621 OF3	x6
	25 mm	B ST PULH 625 OF3	x6
	31 mm	B ST PULH 631 OF3	x6
FX	21 mm	B ST PULH 621 OFX	x6
	25 mm	B ST PULH 625 OFX	x6
	31 mm	B ST PULH 631 OFX	x6
FXL	21 mm	B ST PULH 621 FXL	x6
	25 mm	B ST PULH 625 FXL	x6
	31 mm	B ST PULH 631 FXL	x6
ASSORTII PAKID			
Slider, Shaper, F1, F2, F3	21 mm	B ST PULH 521 SQE	x5
	25 mm	B ST PULH 525 SQE	x5
	31 mm	B ST PULH 531 SQE	x5

ProTaper Ultimate™ Conform Fit® guttaperts tihvtid

Box of 60 gutta-percha points			
F1		B NS PULG FGP OF1	
F2		B NS PULG FGP OF2	
F3		B NS PULG FGP OF3	
FX		B NS PULG FGP OFX	
FXL		B NS PULG FGP FXL	
ASSORTII			
F1-F3		B NS PULG FGP AST	
		12x-F1, 24x-F2, 24x-F3	
ProTaper Ultimate™ pabertihvtid			
Box of 180 absorbent points			
F1		B ST PULP MPP OF1	
F2		B ST PULP MPP OF2	
F3		B ST PULP MPP OF3	
FX		B ST PULP MPP OFX	
FXL		B ST PULP MPP FXL	
ASSORTII			
F1-F3		B ST PULP MPP AST	
		30x-F1, 90x-F2, 60x-F3	
AH Plus® biokeraamiline siiler			
Starter Kit		B KT AHBS 000 000	
Syringe Refill		B 00 AHBS 100 03G	
Cannula Refill		B 00 AHBS 020 24G	
Irrigatsioonikanüül			
	x5	B NS DSIN 522 30G	
	x40	B NS DSIN D22 30G	

Files	Maillefer Instruments Holding Sàrl Chemin du Verger 3, CH-1338 Ballaigues	EC REP	Dentsply DeTrey GmbH De-Trey-Straße 1, D-78467, Konstanz	CE	2797
Gutta-Percha & Absorbent Points	Dentsply Tulsa Dental Specialties 608 Rolling Hills Drive, Johnson City, TN 37604		Dentsply DeTrey GmbH De-Trey-Straße 1, D-78467, Konstanz		2797
Irrigation Needle	Produits Dentaires SA, Rue des Bosquets 18, CH-1800 Vevey		PD Dental EU 74200 Thonon-les-Bains, France		1639
AH Plus® Bioceramic Sealer	Maruchi, 2-208, Medical Industry Complex Bldg., 42-10, Taejunggongdan-gil, Wonju-si, Gangwon-do, KR-26311		Biogeri Am Pfeilshof 12, DE-22303 Hamburg		0197

MAILLEFER ProTaper Ultimate™

Piiramatu sooritus

ROW: Technical modifications on our products are not subject to notifications. Photos of our instruments are not contractual. © 2021 Dentsply Sirona Inc. Rx Only. INL / B EN PTUL BRC 000 / 00 / 2021 - created 07/2021

dentsplysirona.com/protaperultimate
#endopassion

PART OF A
Dental Solution

Dentsply Sirona

Dentsply Sirona

Kujundamine


1 Libetee-kujundus-viimistlus: instrumentide järjestus, mis katab täies ulatuses erinevad anotoomilised olukorrad

Slider - libetee




Enamusel juhtudest võib kasutada kohe, et kujundada libetee*

Kujundusviilid



Täiustatud lõikamisefektiivsus ja preparatsiooniprahi eemaldamine koronaalosa kahes-kolmandikus

Viimistlusviilid



Apikaalses kolmandikus tagab paindumise kõige väljakutsuvamate anotoomiate viimistlemiseks, ilma purunemata ning lahti keerdamata




Meie erinevus


100%

kasutajatest arvab, et ProTaper Ultimate™ instrumentid tagavad ennustatava juurekanali preparatsiooni*

Kujundusaeg

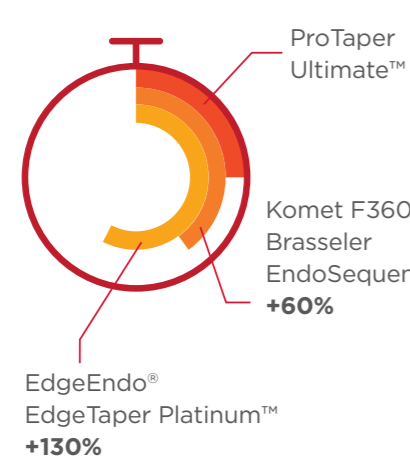

Tugevam - pikem vastupidavusaeg

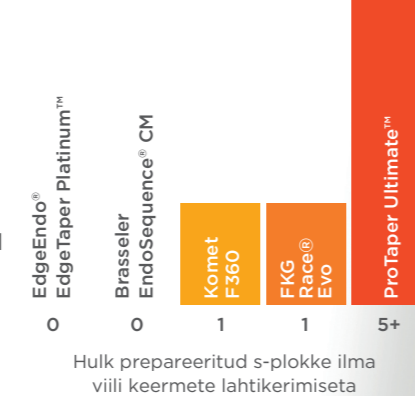

Hulk prepareeritud s-plokke ilma viili keerumete lahtikerimiseta

60% kiirem kui Komet F360 ja Brasseler EndoSequence® CM
130% kiirem kui EdgeEndo® EdgeTaper Platinum™


Puhastus

Enam kui 25% tõhusam puhastus võrreldes aktiveerimata naatriumhüpokloriti lahusega*


Loputusnõel



Loputusnõel kaardub ja paindub tagades efektiivse puhastuse ja desinfitseerimise kuni apeksini





Endoaktivaator




Aktiveeritud vedelikud soodustavad sügavat puhastust ja desinfitseerimise, aidates kaasa 3D obturatsioonile ja pikaajalisele edule



Meie erinevus

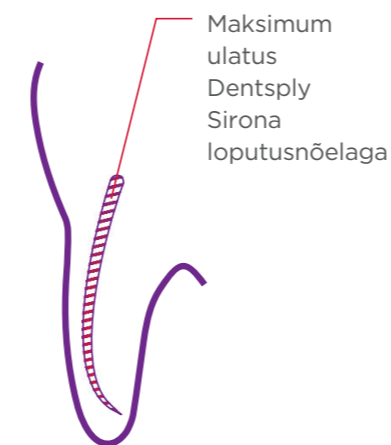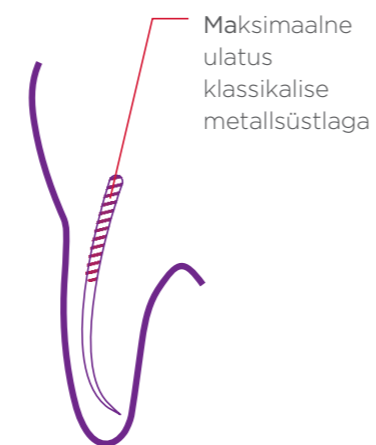

Obtureeritud lateraalsete kanalite keskmiste skooride võrdlus

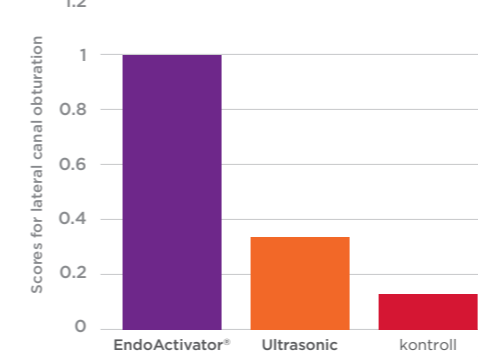

EndoActivator® tagas lateraalsete kanalite parema obturatsiooni, mille tulemusena jäi vähem preparatsiooniprahti**


* Kehtib ainult EndoActivatorile®

** Kanali puhtuse ja obturatsiooni võrdlus: ultraheli kvalitatiivne ja kvantitatiivne analüüs võrreldes helikiirusel endodontiliste süsteemidega; Valerie Weldon, DMD, Uma Nair, DMD, MDS, Claudio Varela, DDS, MS, Keith Kanter, DDS, Kenneth Anusavice, PhD, and Roberta Pileggi, DDS, MS, Gainesville, FL UNIVERSITY OF FLORIDA. (Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2011;112:809-813)

Obturatsioon

Obturatsioon ideaalse sobivusega 100% juhtudest

Biokeraamiline siiler



Bioühilduv ja ei mõjuta periodontaalset kudet



Conform Fit® guttapertši tihvt




Vähem prahti ja ajasäästlik, kuna esimene tihvt sobib iga kord




Meie erinevus

Kõvenemisaeg

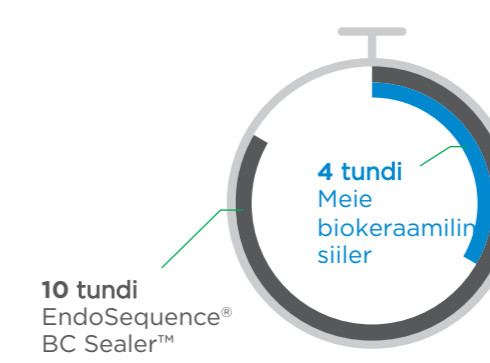

100% sobivus

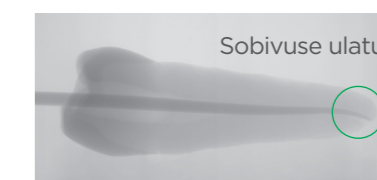

Sobivus Conform Fit® guttapertš tihvtiga

21% sobivus² kasutades odavamaid endodontilisi guttapertši tihvte



Sobivus odavama endodontilise guttapertšiga

1 281 kujundatud kaviteedil mold cavities
2 28 juhulikkude tihvti